


Hapen mittaus kuumasta paikasta  
 Vaatii jäähdtyksen näytekaasulle  
 Näytekaasun lämpötila alle 40 C.

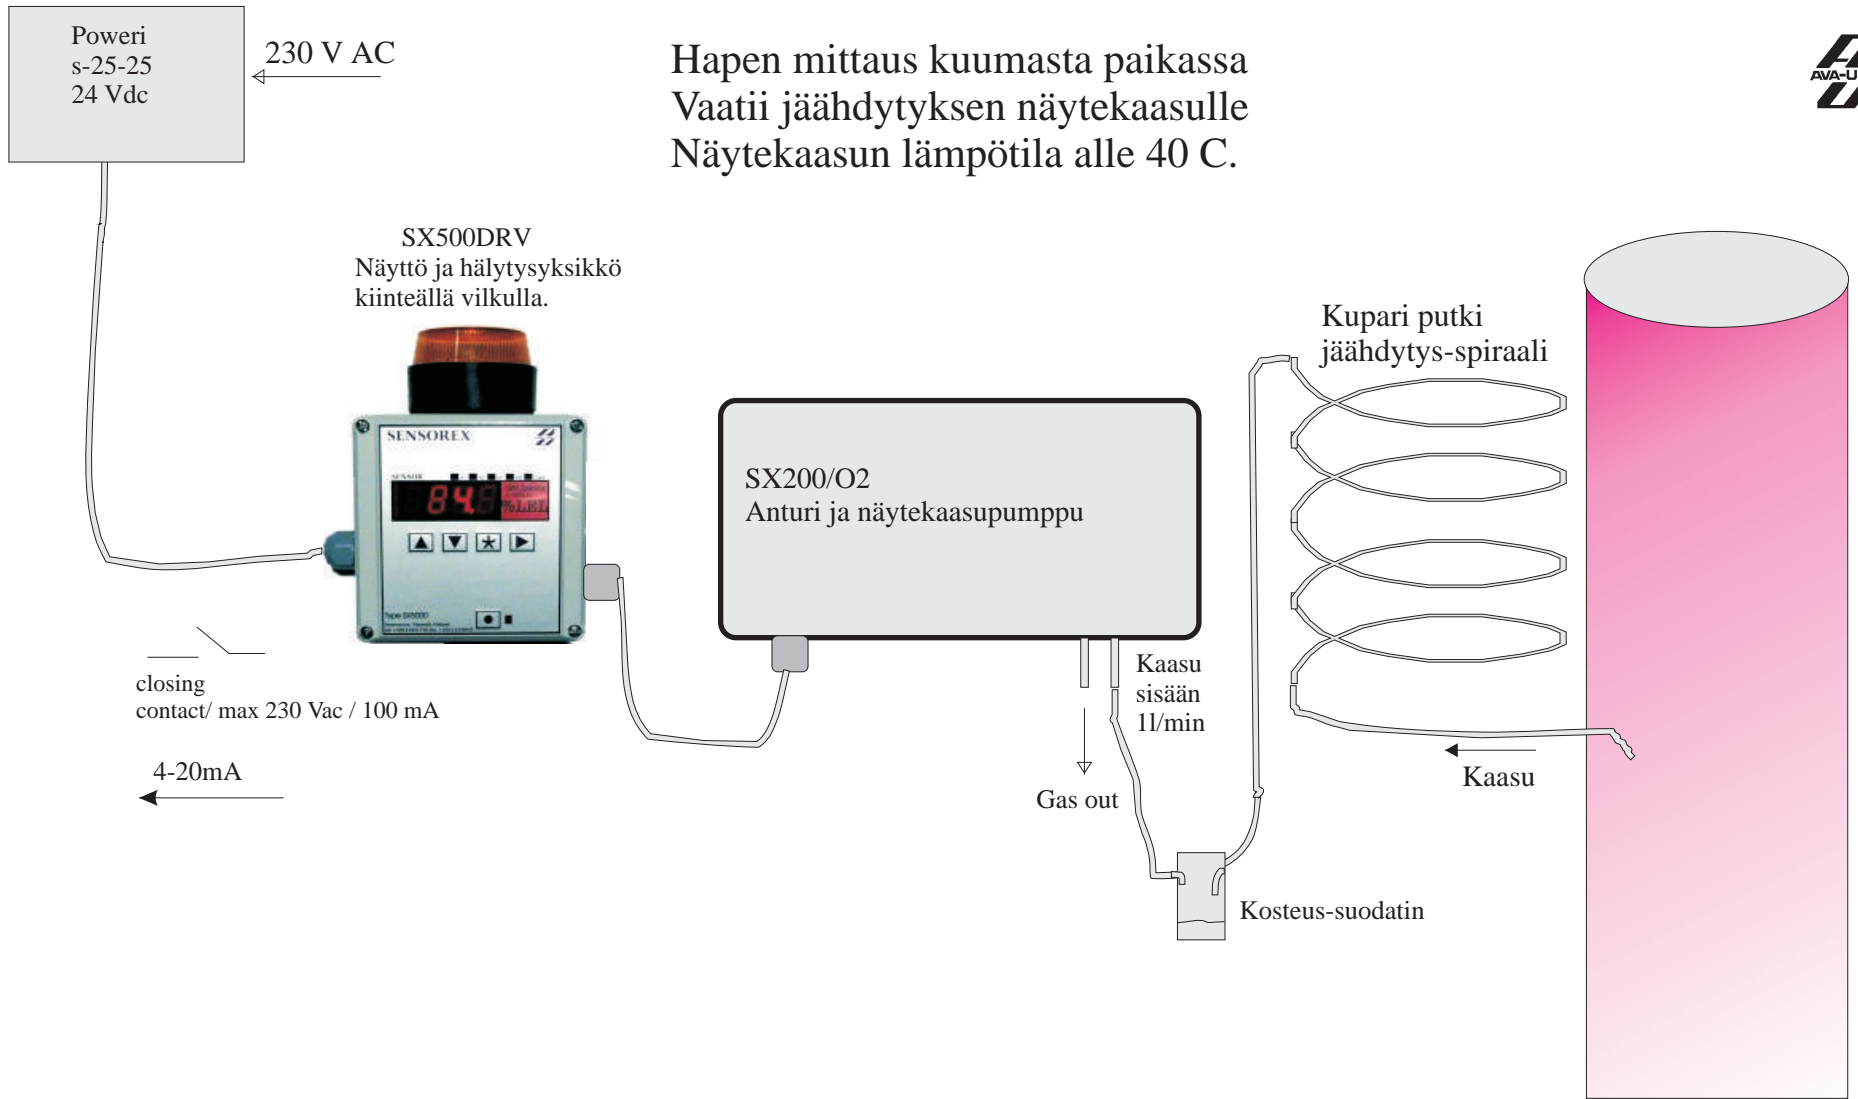

SX 500DRV/EA/+SX200xxxp	17.10..2002
<p><b>Sensorex oy</b></p> <p>p.02-4340750 f. 02-4350643</p>	